Installation des höhenverstellbaren Untersuchungstisches

[Informationen zu den Sicherheitssymbolen - siehe Benutzerhandbuch]

Für Modelle
222 (alle)
223 (alle)
622 (alle)
623 (alle)

Gerätewarnung

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Untersuchungstisch führen.

NIEMALS auf die Sockelverkleidung drücken.

Tisch NIEMALS anhand der Fersenstützen anheben.

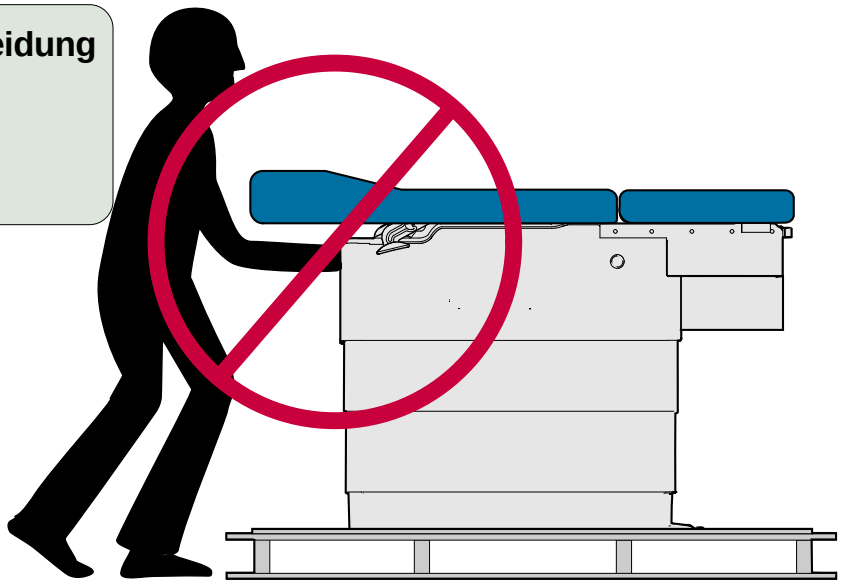

Tisch IMMER erst ganz herunterfahren und dann transportieren.

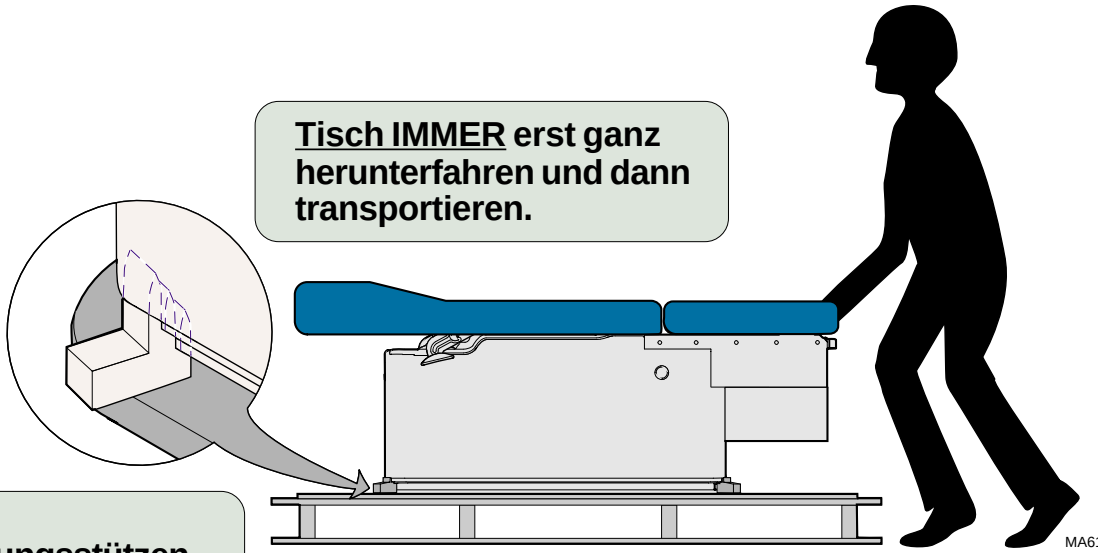

Die vier (4) Sockelverkleidungsstützen NUR entfernen, wenn der Tisch seinen Aufstellungsort erreicht hat.

© Midmark Corporation 2003

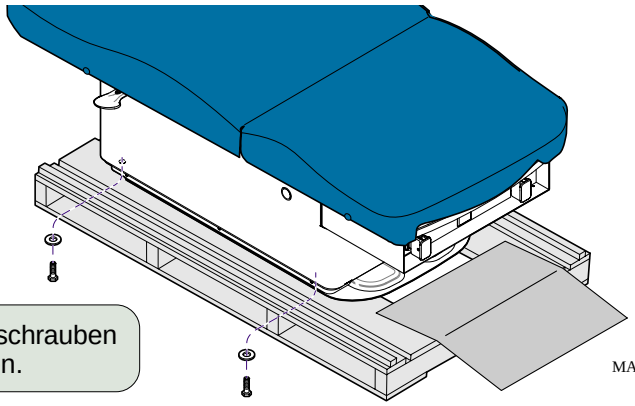

Schritt 1: Versandschrauben entfernen.

MA622700i

Gerätewarnung

Der Tisch muss zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs eben ausgerichtet sein

.



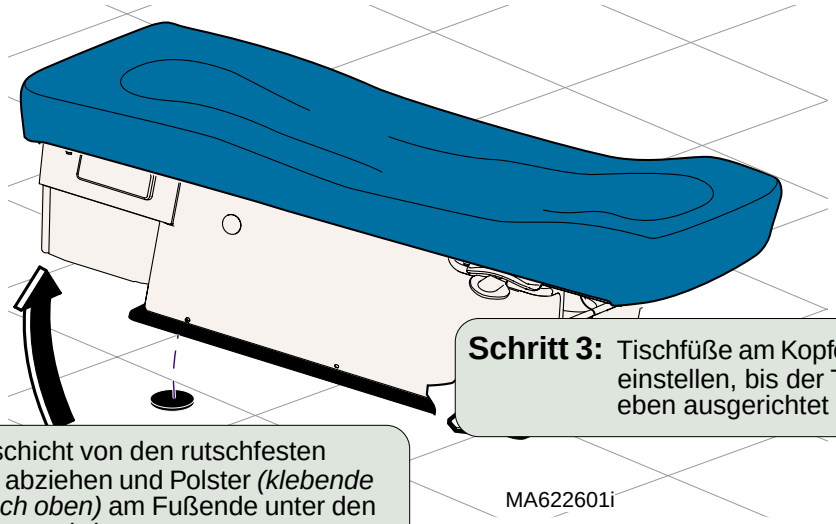

Schritt 3: Tischfüße am Kopfende einstellen, bis der Tisch eben ausgerichtet ist.

Schritt 2: Schutzschicht von den rutschfesten Polstern abziehen und Polster *(klebende Seite nach oben)* am Fußende unter den Tischfüßen anbringen.

MA622601i

Elektrische Nennwerte

Modelle: 222, 223 und 622 (115 VAC)
Dedizierter Versorgungsstromkreis: 115 VAC, 50/60 Hz, 15 A

Modell: 623 (115 VAC)
Dedizierter Versorgungsstromkreis: 115 VAC, 50/60 Hz, 20 A

Modelle: Produktreihe 222 oder 223 (230 VAC)
Dedizierter Versorgungsstromkreis: 230 VAC, 50/60 Hz, 15 A

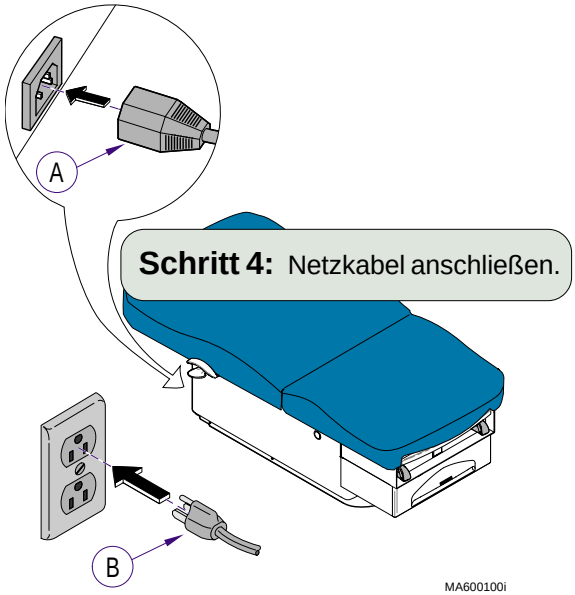

Schritt 4: Netzkabel anschließen.

MA600100i

Hinweis

Dieser Schritt bezieht sich nur auf die Modelle 223 und 623.

Schritt 5: Fußpedal anschließen.
223: *Fußende.*
623: *Fuß- oder Kopfende*

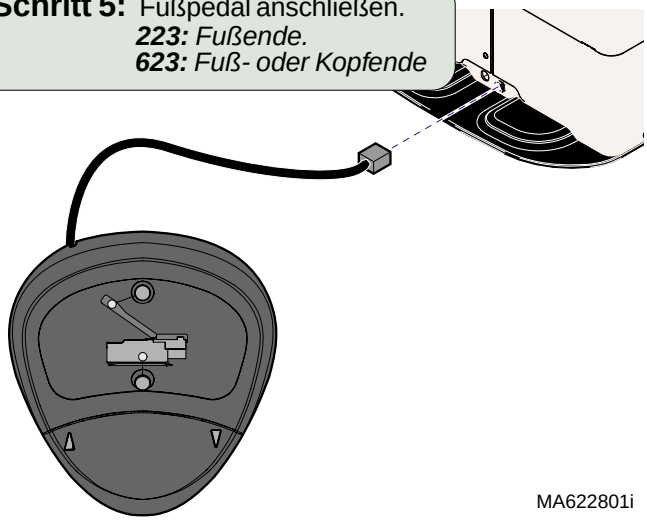

MA622801i

© Midmark Corporation 2003